

Procedura aperta per l'affidamento, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in Service di Sistemi di Navigazione intraoperatoria, materiale di consumo e servizi connessi, da destinare alle Aziende Socio-Sanitarie Locali n. 3 di Nuoro e n. 8 di Cagliari del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 01/08/2025

(Esame offerte tecniche – SEDUTA RISERVATA)

In data 01/08/2025 alle ore 10:30 presso gli uffici della S.C. Acquisti di Beni e Servizi non Sanitari Servizi Sanitari e Service siti in Nuoro in via Demurtas n. 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 25/03/2025, per procedere alla disamina della documentazione tecnica presentata dagli OO.EE. partecipanti e ammessi alla fase di valutazione tecnica.

La Commissione Giudicatrice risulta così costituita:

Dott. Antonello Podda - componente con funzioni di presidente;

Dott. Corrado Bozzo - componente;

Dott. Sergio Pirri - componente

Dott. Pierfrancesco Cappai – componente

Ing. Laura Monni – componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP, Dott. Antonio Sale

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Le Ditte che, entro il termine del 15/05/2025 – ore 13:00, hanno presentato istanza di partecipazione e relativa documentazione sono:

- 1) HF SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO;
- 2) MASMEC S.p.A.;
- 3) MEDICA DI PELLEGRINI SRL.

La commissione procede con l'esame delle offerte tecniche presentate relativamente ai lotti 1 e 2 riferiti alla disciplina Otorinolaringoiatria e per i quali è stata presentata un'unica offerta da parte della Ditta MEDICA di Pellegrini S.r.l.

La commissione accerta la conformità delle offerte relativamente ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis di gara.

Si procede con l'esame delle offerte relativamente ad ogni criterio previsto ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara.

Ogni commissario procede con l'attribuzione di un giudizio qualitativo, ovvero, ove previsto, con l'attribuzione di un punteggio tabellare assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

La Commissione, successivamente al completamento dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'O.E. partecipante per i Lotti 1 e 2, effettuato sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, procede all'attribuzione del coefficiente corrispondente al giudizio che, di volta in volta, è stato espresso da ognuno dei commissari nel corso dell'analisi delle offerte tecniche, con le modalità dettagliatamente descritte al punto 18.2 del Disciplinare di gara.

Le risultanze delle operazioni di valutazione sono riportate nella tabella allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Da quanto sopra risulta ammessa alla fase successiva la Ditta MEDICA di Pellegrini S.r.l. che risulta aver raggiunto un punteggio tecnico complessivo senza riparametrazione pari a 61,40/70 nel lotto 1 e un punteggio tecnico complessivo senza riparametrazione pari a 68,40/70 nel lotto 2.

Si rinvia a successiva convocazione della Commissione l'esame dell'offerta relativa al Lotto n. 3.

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Commissione Giudicatrice


Dr. Antonello Podda – Presidente




Dott. Corrado Bozzo – componente




Dott. Sergio Pirri – componente

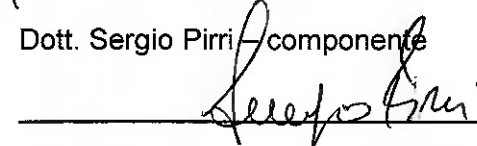

Dott. Pierfrancesco Cappai – componente

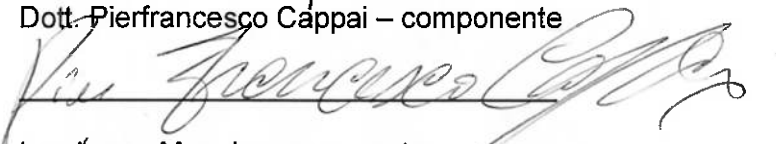


Ing. Laura Monni - componente



Il segretario verbalizzante

Dott. Antonio Sale



Lotto 1: Sistema di Navigazione Intraoperatoria - U.O. Otorinolaringoiatria P.O. SAN FRANCESCO NUORO				VALUTAZIONE OFFERTE MEDICA DI PELLEGRINI SRL							
N°	Criteri di valutazione	Tipologia	Punti max	Giudizio commissario 1: Dott. Pirri	Giudizio commissario 2: Dott. Bozzo	Giudizio commissario 3: Dott. Cappai	Giudizio commissario 4: Ing. Monni	Coefficiente medio commissione (in caso di criterio discrezionale)	Punteggio commissione	Riferimento offerta tecnica	Note
1	Caratteristiche tecniche e funzionamento della workstation (disponibilità di un secondo monitor, dimensioni e risoluzione del/i monitor, CPU, Hard disk, dimensioni e ingombro in sala, altro)	Discrezionale descrivere	8	Buono	Buono	Buono	Buono	0,8	6,4	PG 23-25 Relazione offerta tecnica criterio 1	Nella configurazione offerta non è presente il secondo monitor, per questo motivo la commissione esprime giudizio buono
2	Numero e tipologia di posizionamento dell'emettitore EM	Discrezionale descrivere	7	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	7	PG 26-27 Relazione offerta tecnica criterio 2	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
3	Compatibilità dei sistemi navigati con i sistemi motorizzati in dotazione all'U.O.	SI/NO	7	NO	NO	NO	NO		0	PG 28 Relazione offerta tecnica criterio 3	Il sistema è totalmente compatibile con la consolle e i manipoli motorizzati microdebrider a marchio Medtronic in dotazione. Presso L'U.O. ORL del P.O. S. Francesco è in uso, oltre la consolle medtronic, anche la consolle Storz, pertanto il sistema non può essere considerato compatibile con quest'ultima, della quale è stata data evidenza in sede di sopralluogo
4	Disponibilità software con funzione di endoscopia virtuale 3D	SI/NO	6	SI	SI	SI	SI		6	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	
5	Caratteristiche tecnico-funzionali del software di pianificazione ORL offerti - descrivere	Discrezionale descrivere	8	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	8	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
6	Pianificazione con marcatura di strutture a rischio con target point con misurazione delle distanze prima dell'intervento e rilevazione costante intraoperatoria, durante l'utilizzo, della distanza esatta dalla struttura a rischio.	Discrezionale descrivere	6	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	6	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
7	Caratteristiche tecnico-funzionali del software di navigazione ORL offerti - descrivere	Discrezionale descrivere	8	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	8	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
8	Tipologia e composizione dei set di strumenti richiesti (ed eventuali ulteriori) a corredo del sistema di navigazione	Discrezionale descrivere	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	10	PG 31-34 Relazione offerta tecnica criterio 8	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
9	Struttura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk (tempi di intervento, tempi di risoluzione, sede assistenza tecnica più vicina, numero tecnici abilitati per assistenza tecnica, tempi disponibilità muletto)	Discrezionale descrivere	5	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	5	PG 35-38 Relazione offerta tecnica	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
10	Programmazione di almeno 1 corso di aggiornamento annuale per utilizzatori	SI/NO	5	SI	SI	SI	SI		5	PG 35 Relazione offerta tecnica criterio 10	

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	61,4
---------------------------	------






VALUTAZIONE OFFERTE												
Lotto 2: Sistema di Navigazione Intraoperatoria - U.O. Otorinolaringoiatria P.O. SS TRINITA' CAGLIARI				MEDICA DI PELLEGRINI SRL								
N°	Criteri di valutazione	Tipologia	Punti max	Giudizio commissario 1: Dott. Podda	Giudizio commissario 2: Dott. Pirri	Giudizio commissario 3: Dott. Bozzo	Giudizio commissario 4: Dott. Cappai	Giudizio commissario 5: Ing. Monni	Coefficiente medio commissione (in caso di criterio discrezionale)	Punteggio commissione	Riferimento offerta tecnica	Note
1	Caratteristiche tecniche e funzionamento della workstation (disponibilità di un secondo monitor, dimensioni e risoluzione del/i monitor, CPU, Hard disk, dimensioni e ingombro in sala, altro)	Discrezionale descrivere	8	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	0,8	6,4	PG 23-25 Relazione offerta tecnica criterio 1	Nella configurazione offerta non è presente il secondo monitor, per questo motivo la commissione esprime giudizio buono
2	Numero e tipologia di posizionamento dell'emettitore EM	Discrezionale descrivere	7	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	7	PG 26-27 Relazione offerta tecnica criterio 2	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
3	Compatibilità dei sistemi navigati con i sistemi motorizzati in dotazione all'U.O.	SI/NO	7	SI	SI	SI	SI	SI		7	PG 28 Relazione offerta tecnica criterio 3	
4	Disponibilità software con funzione di endoscopia virtuale 3D	SI/NO	6	SI	SI	SI	SI	SI		6	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	
5	Caratteristiche tecnico-funzionali del software di pianificazione ORL offerti - descrivere	Discrezionale descrivere	8	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	8	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
6	Pianificazione con marcatura di strutture a rischio con target point con misurazione delle distanze prima dell'intervento e rilevazione costante intraoperatoria, durante l'utilizzo, della distanza esatta dalla struttura a rischio.	Discrezionale descrivere	6	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	6	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
7	Caratteristiche tecnico-funzionali del software di navigazione ORL offerti - descrivere	Discrezionale descrivere	8	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	8	PG 29-31 Relazione offerta tecnica criterio 4-5-6-7	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
8	Tipologia e composizione dei set di strumenti richiesti (ed eventuali ulteriori) a corredo del sistema di navigazione	Discrezionale descrivere	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	10	PG 31-34 Relazione offerta tecnica criterio 8	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
9	Struttura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk (tempi di intervento, tempi di risoluzione, sede assistenza tecnica più vicina, numero tecnici abilitati per assistenza tecnica, tempi disponibilità muletto)	Discrezionale descrivere	5	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	5	PG 35-38 Relazione offerta tecnica	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
10	Programmazione di almeno 1 corso di aggiornamento annuale per utilizzatori	SI/NO	5	SI	SI	SI	SI	SI		5	PG 35 Relazione offerta tecnica criterio 10	

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	68,4
---------------------------	------